MANICO KEELER SLIMLINE

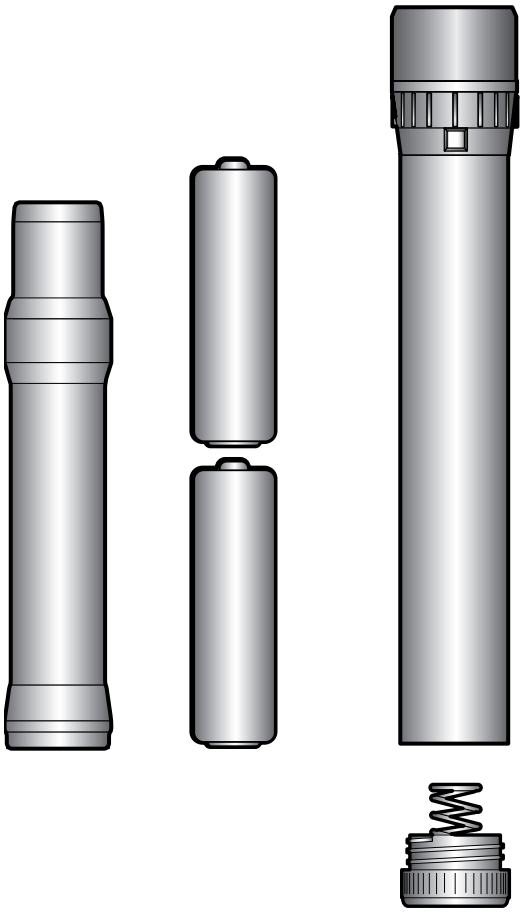

LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Manico Keeler Slimline
Leggete attentamente la presente Sezione sulle Istruzioni prima di utilizzare il prodotto Keeler da Voi acquistato.
Per la Vostra sicurezza e quella dei Vostri clienti, Vi invitiamo a seguire tutte le informazioni fornite nella presente sezione, intese ad evidenziale potenziali pericoli alla sicurezza associati all'incorretto utilizzo del prodotto integro o danneggiato.

⚠ **Avvertenza**

Non utilizzare il prodotto in presenza di gas infiammabili.

Non smontare o modificare la batteria, al cui interno non sono presenti parti soggette a manutenzione.

Non smaltire la batteria in un fuoco vivo né perforarla.

Non utilizzare una batteria deformata, che presenti segni di perdite, corrosa o visibilmente danneggiata.

Se il prodotto emana odore anomalo, calore o fumo, interromperne l'utilizzo immediatamente. L'uso continuo di un prodotto o componente danneggiato può provocare danni alle persone o alle proprietà.

Non immergere l'unità in alcun liquido.
Non usare l'unità se danneggiata e controllarla periodicamente per individuare eventuali segni di danni.

Nel caricatore Keeler Slimline, usare solo manici ricaricabili Keeler (base rossa). Non cercare di inserire un manico Keeler con la base blu nei caricatori Keeler per batterie ricaricabili. Fare riferimento alla sezione sull'identificazione dei manici e delle lampadine Keeler.

Attenzione
Se lo strumento non viene usato per un lungo periodo rimuovere le batterie a secco.

Usare solo la batteria ricaricabile Keeler – N. parte EP39 18918

Caricare esclusivamente con i caricatori Keeler –
N. parte 1941-P-5289, Caricatore doppio
1941-P-5326, Minicaricatore

Non usare tipi di batterie diversi.

Non caricare la batteria in ambienti la cui temperatura possa eccedere i 40°C o scendere al di sotto di 0°C.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Da usarsi solo all'interno di ambienti (proteggere dall'umidità).

Onde impedire la formazione di condensa, lasciare che lo strumento raggiunga la temperatura ambiente prima dell'utilizzo.

Quando si fissano le teste degli strumenti ai manici controllare che il voltaggio della lampadina corrisponda al voltaggio del manico.
Assicurarsi che a completamento dell'esame il controllo sia nella posizione *off*.

Quando si sostituisce la cella al litio, ruotare il manico nella posizione *off* e inserire una nuova cella. Rimontare il tappo inferiore e inserire il manico nell'alloggiamento di carica.

Informazioni ambientali
Smaltire la batteria conformemente ai regolamenti locali sul riciclaggio delle batterie.

Picchiettare sui contatti della batteria onde evitare cortocircuiti durante lo smaltimento.

Le batterie agli ioni di litio non contengono metalli pesanti tossici quali mercurio, cadmio o piombo.

Identificazione dei manici e delle lampadine Keeler
I manici e le lampadine Keeler sono codificati a colori per consentire di distinguere fra un manico con batterie a secco (2.8v) e un manico ricaricabile (3.6v). Il codice a colori è il seguente:

Base blu = 2.8v per batterie a secco

Base rossa = 3.6v per batterie ricaricabile

Quando si sostituiscono le lampadine, verificare che il voltaggio corrisponda a quello del manico.

Inserimento/Sostituzione delle batterie

Svitare il tappo del vano batterie, inserire le batterie e rimontare il tappo, come illustrato nella Fig 1.

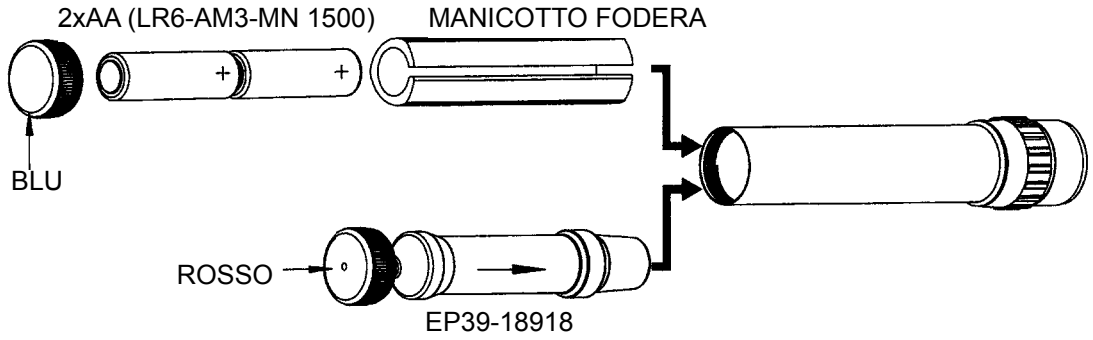

Fig. 1



Connessione della testa dello strumento al manico

La connessione della testa dello strumento al manico avviene tramite una vite filettata. Connettere come indicato e ruotare in senso orario. Assicurarsi che la connessione fra la testa e il manico sia positiva.



Compatibilità

Gli Oftalmoscopi Specialist, Professional, Standard e Practitioner Keeler e i Retinoscopi Keeler sono compatibili con i manici Keeler 2.8v e 3.6v.



SPENTO

Controllo illuminazione on/off

Per accendere lo strumento ruotare il controllo illuminazione a destra come indicato. Per spegnere lo strumento ruotare il controllo a sinistra come indicato. I manici Keeler slimline sono provvisti di indicatore della potenza, il quale avverte se lo strumento è acceso o spento.



ACCESO A META

Rosso = acceso Argento = spento

COMPLETAMENTE ACCESO

Identificazione del manico

I manici Keeler Slimline vengono individuati con un codice di colori che permette di distinguere fra un manico con batterie a secco (2.8v) e un manico ricaribile (3.6v). Il codice di colori è il seguente:

Base blù = 2.8v per batterie a secco (munito di canna con manicotto)

Base rossa = 3.6v per batterie ricaricabili

Istruzioni per la pulizia
Per lo strumento, eseguire unicamente una pulizia manuale, come qui sotto descritta, senza immergere l'unità in alcun liquido:

1. Detergere la superficie esterna con un panno pulito ed assorbente, che non lasci peli, inumidito con una soluzione di acqua/detergente (2% di detergente per volume d'acqua) oppure una soluzione di acqua e alcol isopropilico (70% IPA per volume d'acqua).

2. Assicurarsi che un eccesso di soluzione non penetri nello strumento. Fare attenzione che il panno non sia troppo bagnato.

3. Le superfici devono essere asciugate attentamente usando un panno pulito che non lasci peli.

4. Non disperdere la soluzione nell'ambiente dopo l'uso, ma eliminarla in modo sicuro.

Garanzia e manutenzione
Il prodotto non contiene parti sulle quali l'utente può effettuare la manutenzione – tutte le operazioni di manutenzione preventiva e servizio devono essere eseguite unicamente da rappresentanti autorizzati Keeler.

Il Vostro Manico Keeler è garantito per 3 anni e verrà sostituito o riparato gratuitamente, soggetto alle seguenti condizioni:

1. Qualsiasi guasto deve essere un guasto di fabbricazione.
2. Qualsiasi richiesta di sostituzione/riparazione deve essere corredata dalla ricevuta/scontrino di acquisto.

PRODOTTO NEL REGNO UNITO DA:

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA
Inghilterra
Tel: +44 (0)1753 857177
Fax: +44 (0)1753 827145
NUMERO VERDE: 0800 521 251

DISTRIBUITO DA:

Keeler Instruments Inc
456 Parkway
Broomall
PA 19008, USA
Numero verde: 1 800 523 5620
Tel: 610 353 4350
Fax: 610 353 7814

'Il marchio CE indica che questo prodotto è stato testato e risulta conforme alle norme definite nella direttiva 93/42/EEC sui dispositivi medicali'

A HALMA GROUP COMPANY

Distributore